
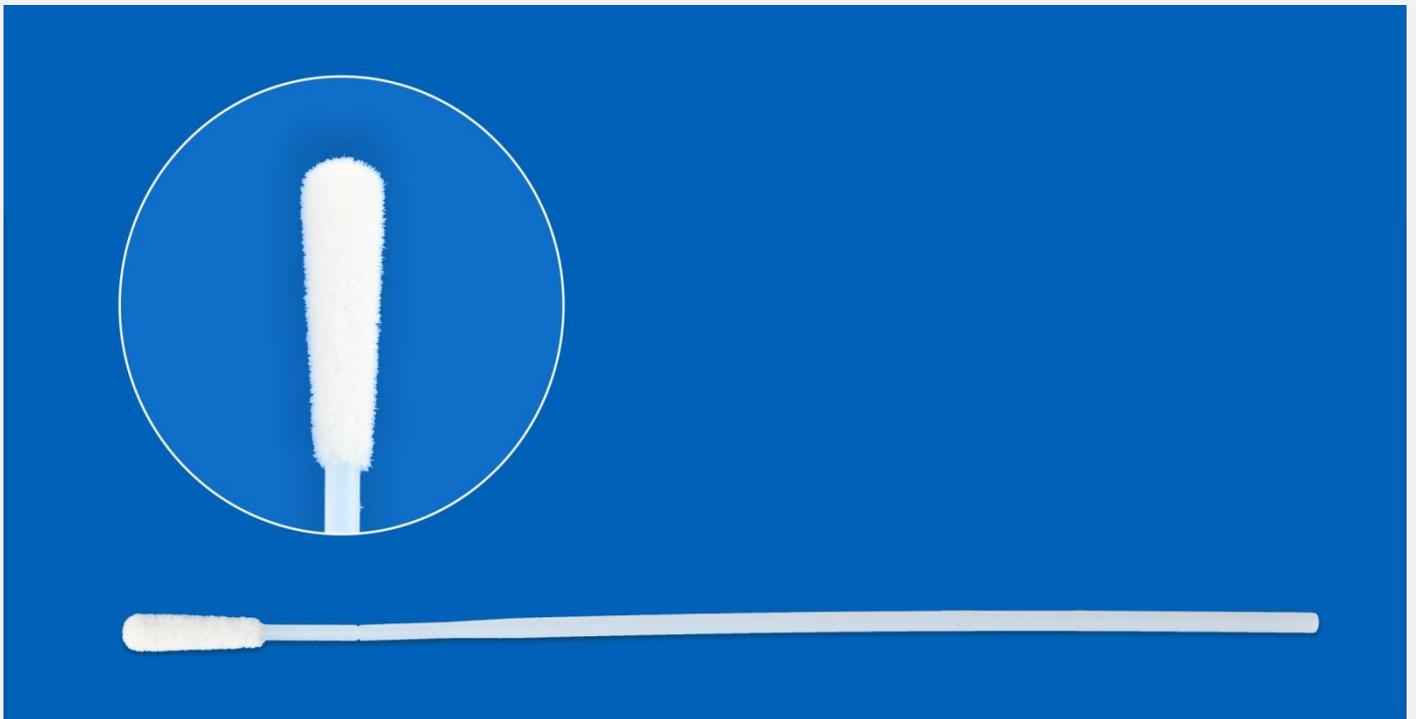


MS-LF7802 植绒（咽喉）采样拭子，总长度 150mm 折断口 30mm，采样杆材质为 PS。

LF7802 植绒拭子主要也是用于咽喉的样本采集，LF7802 与 LF7801 最大的区别是折断口的长度不同。LF7802 目前被广泛应用于核酸混检，30 的折断口可搭配 2ml 及 5ml 的保存瓶。

产品尺寸图及照片

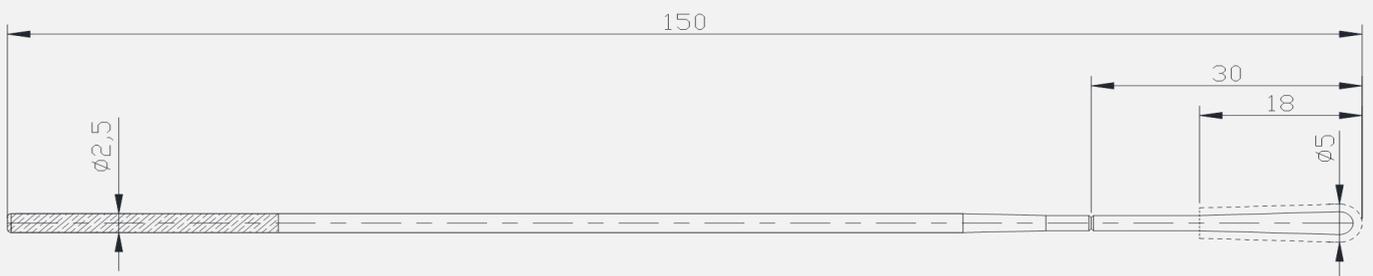

灭菌方式及产品性能

我们采用 E0 灭菌，出厂时环氧乙烷残留值不高于 10ug/g。产品存储温度为-5-35 度，有效期为 3 年。